



COMPONENTS FOR MEDICAL PRODUCTS ASSEMBLY
COMPONENTI PER ASSEMBLAGGIO PRODOTTI MEDICALI

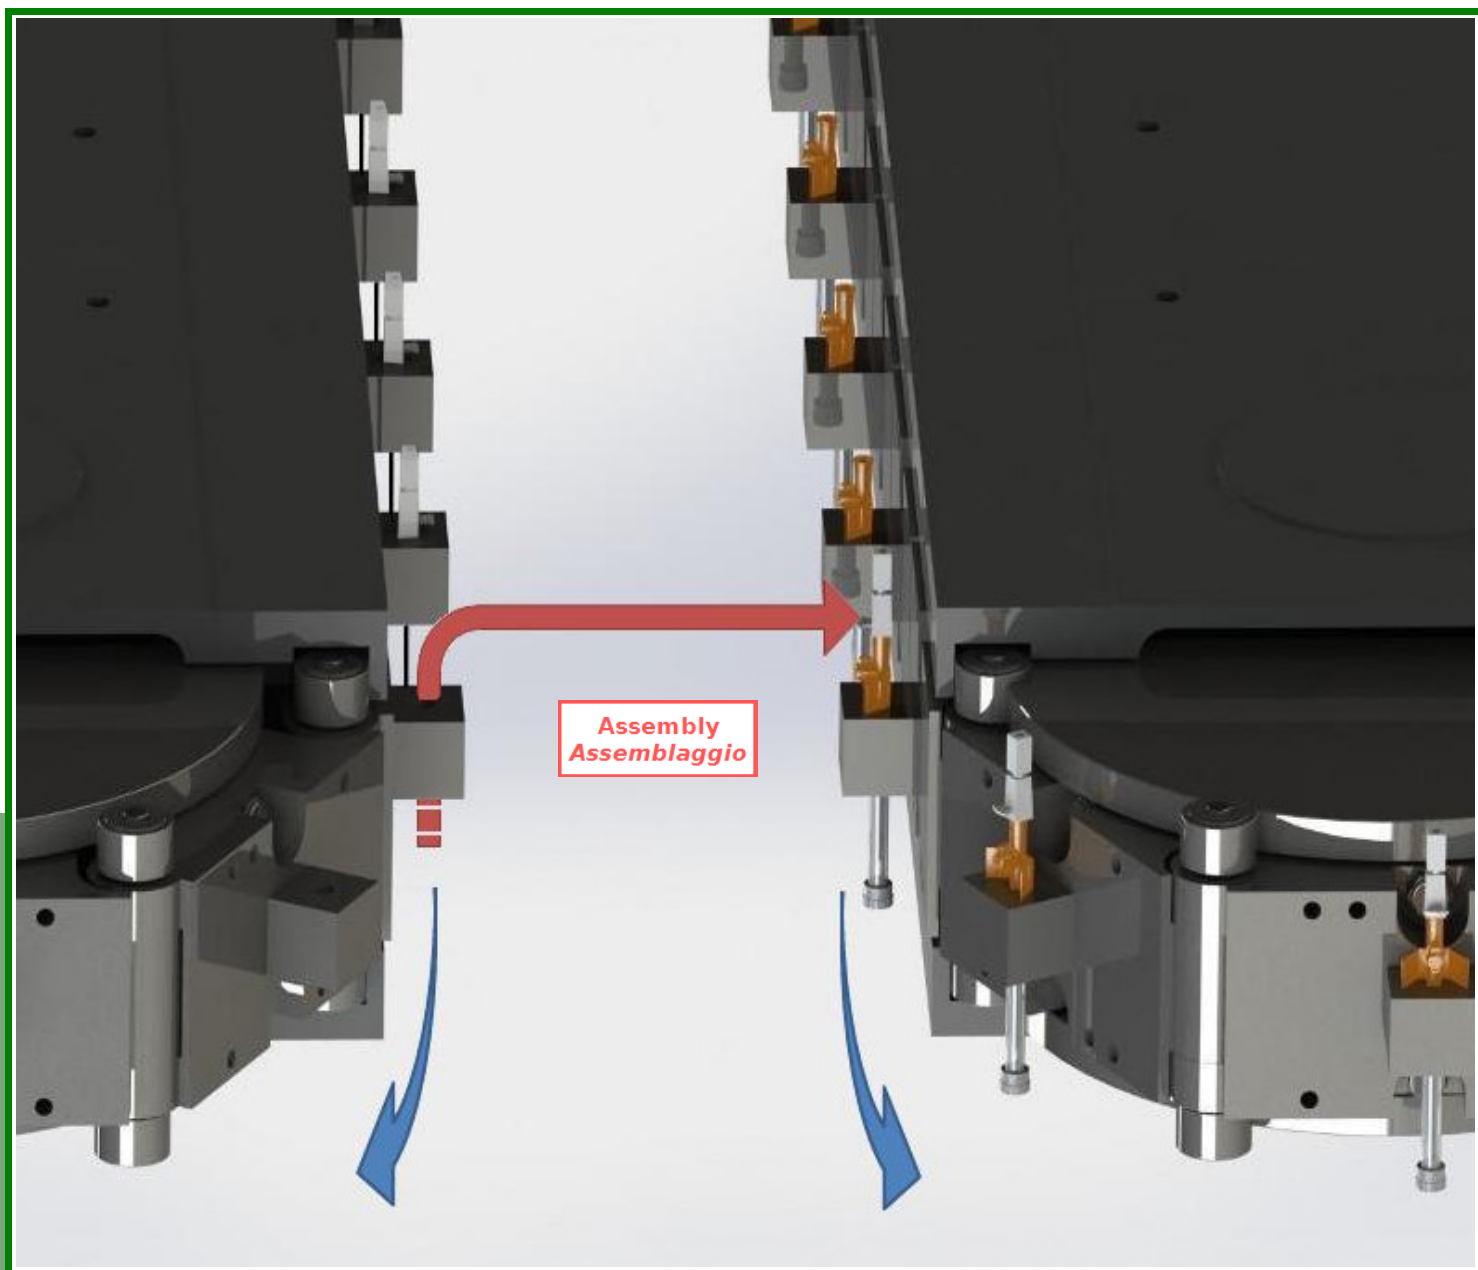


STEP 1

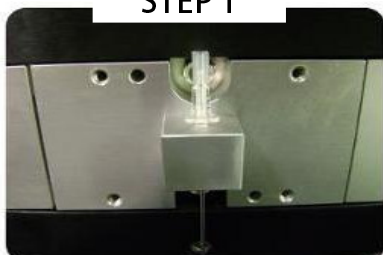


Needle carried by left PLC
La siringa è caricata dal PLC di sinistra

STEP 2

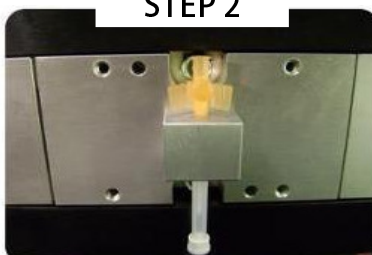

Needle cover carried by right PLC
L'involucro della siringa caricato dal PLC di destra

STEP 3

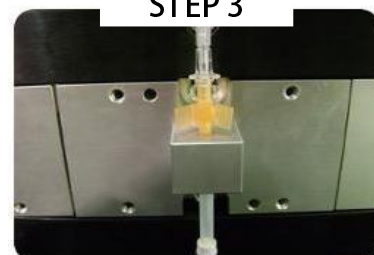


Needle mounted in cover
Siringa montata nell'involucro

NEEDLE CANNULA ASSEMBLY with TWO PLC
ASSEMBLAGGIO AGO CANNULA




ITALPLANT DISTRIBUTORS IN THE WORLD – DISTRIBUTORI ITALPLANT NEL MONDO
ITALPLANT VERTRETERN IN DER WELT – ITALPLANT DISTRIBUTEURS DANS LE MONDE

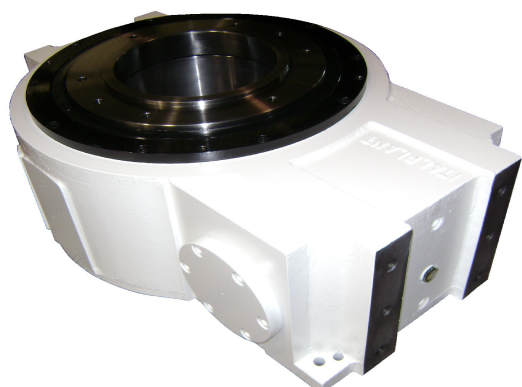

GLOBOIDALCAM INDEXING UNITS HIGH SPEED 1000 RPM
*TESTE A DIVIDERE A CAMMA GLOIBOIALE
AD ALTA VELOCITA' 1000 C/1'*



**ADJUSTABLE TRANSMISSION TORQUE (ATT) WITH
SAFETY OUTPUT TORQUE LIMITER (SOTL)**
*INTERMITTORI CON REGOLAZIONE DELLA COPPIA TRASMESSA
E LIMITATORE DI COPPIA DI SICUREZZA IN USCITA*

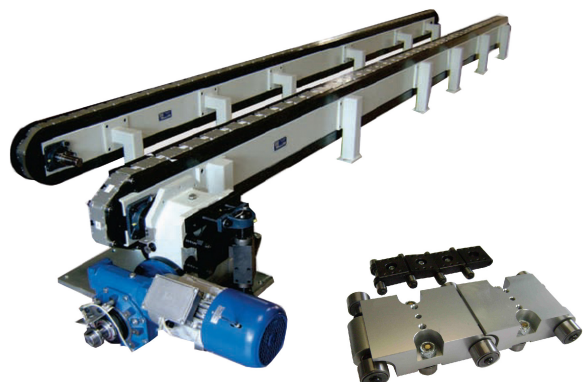

PRECISION LINK CARRIERS
TRASPORTATORI A PASSO DI PRECISIONE



HIGH SPEED TOROIDAL INDEXERS
TESTE A DIVIDERE TOROIDALI AD ALTA VELOCITA'

PLEASE CONTACT OUR TECHNICAL OFFICE FOR FURTHER INFORMATION
CONTATTA IL NOSTRO UFFICIO TECNICO PER ULTERIORI INFORMAZIONI



Via Gonin, 45/A, 45/B - 10137 Torino (Italy)
Tel. + 39.011.30.92.177 - 30.99.485 - Fax + 39.011.30.95.080
www.italplant.com - e-mail: info@italplant.com